

2020年12月吉日

各連携施設

誤接続防止コネクタ導入ご担当者様

## 誤接続防止コネクタ導入に関するご案内

拝啓貴施設に置かれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、この度当院では厚生労働省発出の「相互誤接続防止コネクタに関わる国際規格の導入について」を受け、2021年2月1日より経腸栄養分野において誤接続防止コネクタ製品を導入する運びとなりました。

つきましては、連携施設間での混乱を避けるため、当院での導入状況について貴施設と情報共有したく存じます。

裏面に今回の変更点に関して記載させて頂きましたので、内容をご確認くださいませよう宜しくお願い致します。

なお、ご不明な点がございましたら、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

御多用のところ恐縮ではございますが、円滑な施設間連携を図るため、何卒ご協力のほどよろしくお願い致します。

社会医療法人 生長会  
ベルランド総合病院

# 誤接続防止コネクタの導入に関するご案内

この度、厚生労働省通知を受け、誤接続防止コネクタ製品を導入する運びとなりました。  
今後の円滑な施設間連携を図るため、ご理解ご協力の程、宜しくお願い致します。

## 当院の製品切り替え予定

**2021年2月1日(月曜日)**をもって一斉に製品の切り替えを実施します。

※ただし入院患者様・外来患者様ともに、現在使用(留置)されている方に関しては、  
交換時期を目処に新規製品を使用させていただきます。

## 今後の対応

切り替え日以降は、右図の**新規格タイプ**の「オスコネクタ」を使用します。

このタイプの製品に接続するためには、



- ①「**新規格メスコネクタ**」の製品を直接接続する。
- ②「**変換コネクタ**」を介して既存規格オスの製品と接続する。

のどちらかで対応する必要があります。

特に旧規格と新規格で異なる接続を行う場合には、「**変換コネクタ**」がないと接続できません。

※新規格コネクタの供給都合上、一部製品は既存規格を使用する場合がございます

今回の規格変更について、施設間での混乱が無いよう、お手数をおかけしますが、ご協力のほど宜しくお願い致します。

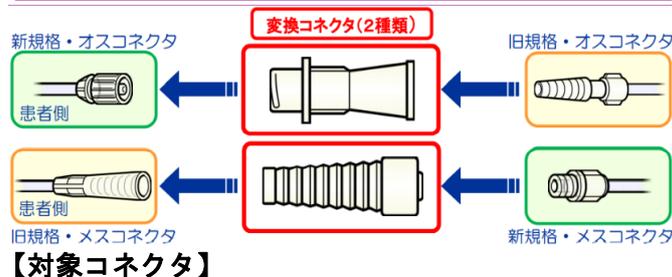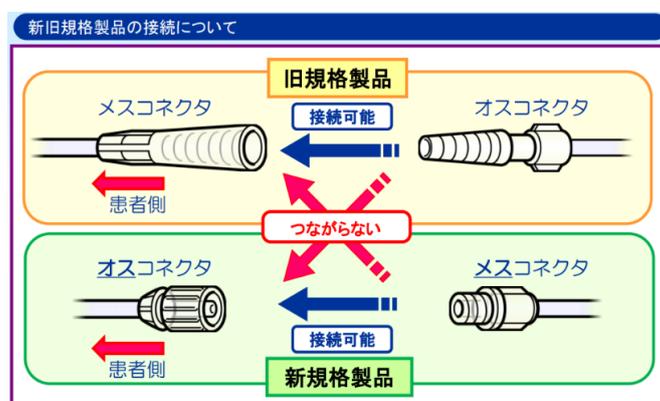

- ☑ 経鼻栄養用カテーテル
  - ☑ 経腸栄養投与セット
  - ☑ 経腸栄養用延長チューブ
  - ☑ 経腸栄養用活栓
  - ☑ 胃ろう用カテーテル (PEGチューブ・ポタン)
  - ☑ 注入器(栄養用)
- 等

## 連携施設様へのお願い

2021年2月1日(月曜日)以降については、貴施設におかれましても「**変換コネクタ**」のご準備、もしくは新規格製品への切り替えをお願いします。

## 問い合わせ・連絡先

社会医療法人 生長会 ベルランド総合病院